

上海市医药采购服务与监管信息系统

用户使用手册（冠脉球囊类医用耗材信息维护）

目录

1. 集中招采申报.....	1
1.1. 冠脉球囊外省市带量采购中选价格维护.....	1

1. 集中招采申报

1.1. 冠脉球囊外省市带量采购中选价格维护

登陆医疗器械资政系统 <http://biz.smpaa.cn/ysxtqx>，如图 1-1 所示：



图 1-1 登陆页面

点击【企业—集中招采申报—冠脉球囊外省市带量采购中选价格维护】模块填报耗材的外省市带量采购价格信息。如图 1-2 所示：



图 1-2 填报页面

企业需要下载【上海市冠脉球囊类医用耗材集中带量采购企业承诺书】模版，加盖企业公章并扫描附件，转为 PDF 格式的文件进行上传。如图 1-3 所示：



图 1-3 模版下载

冠脉扩张导管（快速交换型）必选选择对应的耗材特征属性，冠脉药物涂层导管不需要选择。如图 1-4 所示：

点击单元格可填报耗材对应省市的带量采购价格（包含全部已公布的带量采购价格），同一采购联盟（如贵渝琼）下所有省市区的的价格必须填写且保持一致。

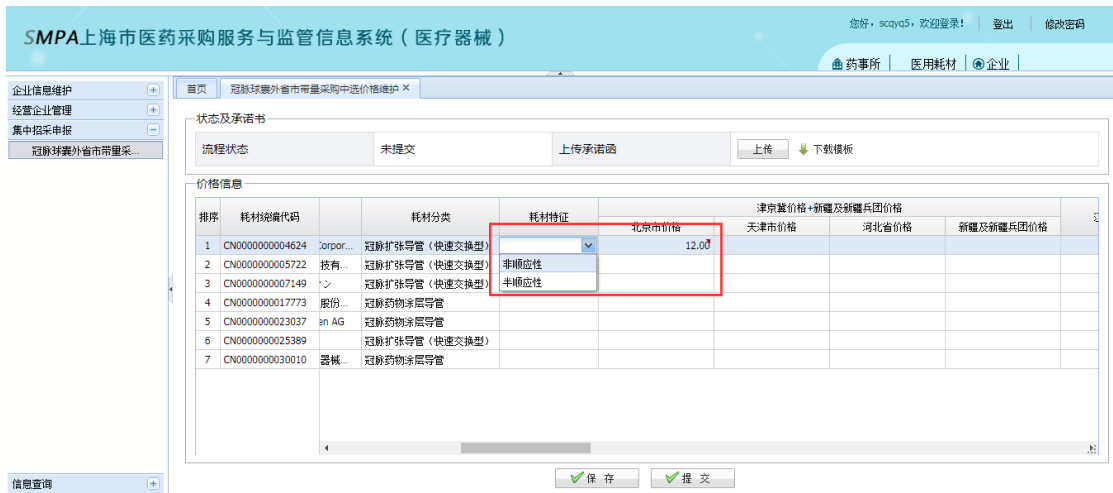


图 1-4 模版下载

在价格填报过程中，可以点击【保存】暂存数据，以便于及时上传数据避免数据丢失。

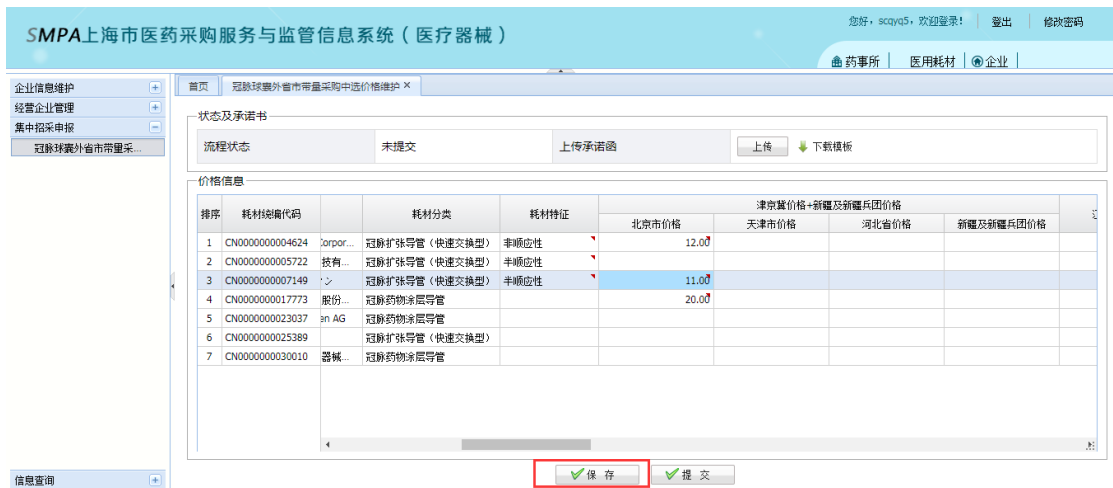


图 1-5 保存

价格填报完成以后，可以点击【提交】完成外省市带量采购价格填报工作。提交前必须上传承诺书，否则不允许提交。如图 1-6 所示：

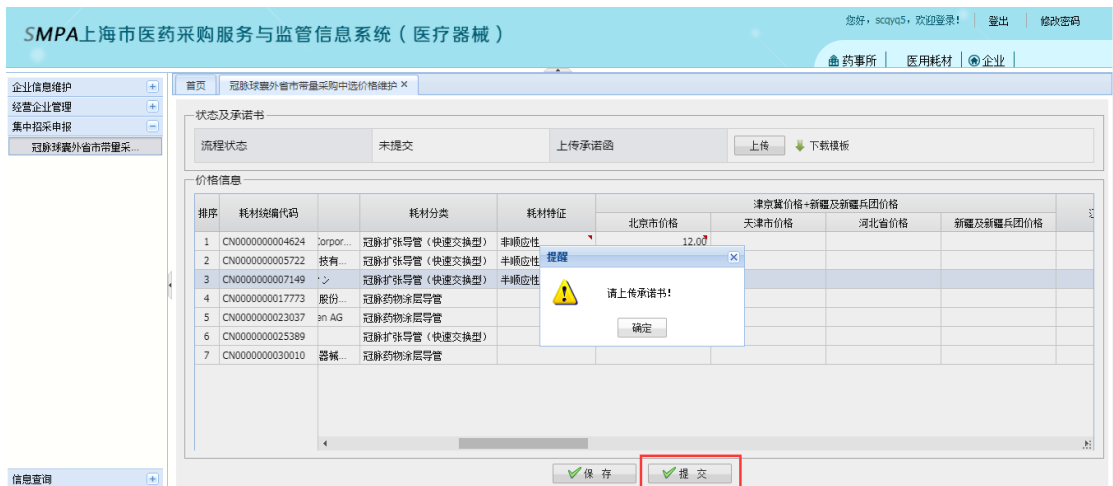


图 1-6 提交