

# 上海市医药采购服务与监管信息系统

## 用户使用手册（人工晶体报量）

第一版

## 目录

目录 .....	2
1. 登陆界面.....	3
2. 医疗机构.....	4
2.1. 人工晶体报量（第二批） .....	4

# 1. 登陆界面



图 1-1-1: 用户登陆页面

在 IE 地址栏输入 <http://XXXXXXXX/ysxtqx>, 然后输入用户名和密码,点击【提交】按钮

医疗机构用户登录后页面:



## 2. 医疗机构

### 2.1. 人工晶体报量（第二批）



图 2-1-1 人工晶体报量（第二批）页面

- 打开页面后系统分两部分展示人工晶体报量信息，这两部分分别是基础信息和人工晶体报量信息。
- 基础信息为当前登录医疗机构人工晶体报量基础信息，该部分信息为系统展示部分，不可修改。
- 人工晶体报量信息列表中展示的信息为当前登录医疗机构待申报的报量信息。
- 根据实际情况申报需求量信息。
- 当需求量超过参考量 120%，需要医疗机构填写情况说明，如下图 2-1-3 所示。反之，情况说明为不可填写状态。

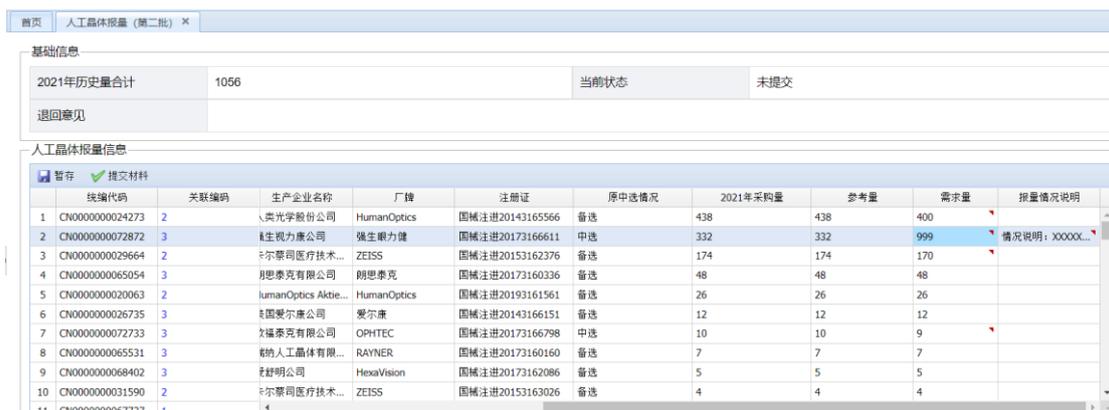


图 2-1-2 必须填写情况说明的情况

- 如果总量低于 90%或中选备选品种需求量低于 80%，则【提交材料】按钮为灰色，如下图 2-1-3 所示，不可提交。

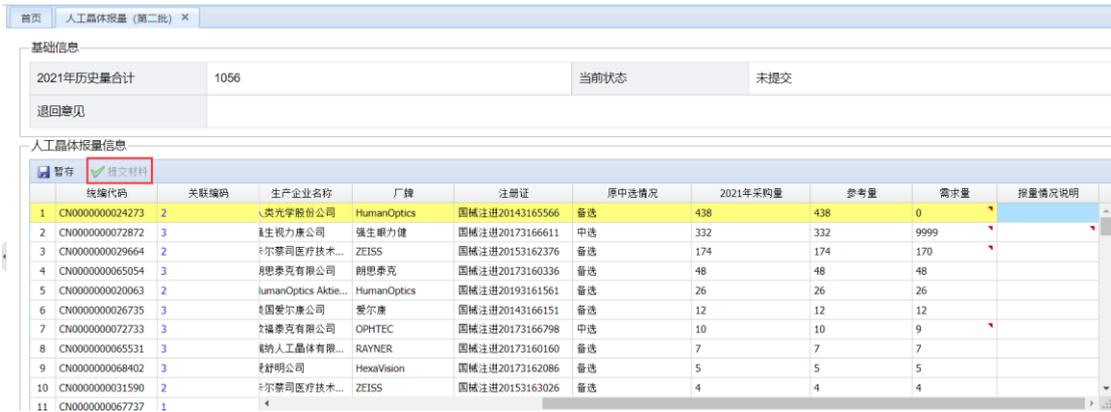


图 2-1-3 不可提交材料的情况

- 点击【暂存】按钮，系统会将已录入的内容保存至库中。
- 点击【提交材料】按钮，如下图 2-1-4 所示，会出现是否确定提交的对话框，点击【确定】按钮则系统会提交已录入的信息至相关部门进行审核，点击【取消】按钮则系统不进行任何操作。

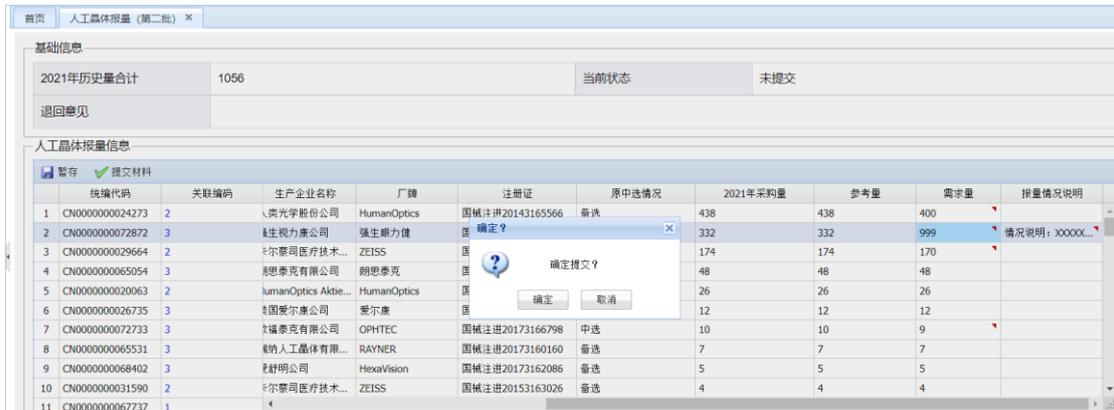


图 2-1-4 是否确定提交对话框

- 提交成功后，页面上【暂存】按钮和【提交材料】按钮会变灰，不能再操作任何修改，如下图 2-1-5 所示。请耐心等待审核结果。

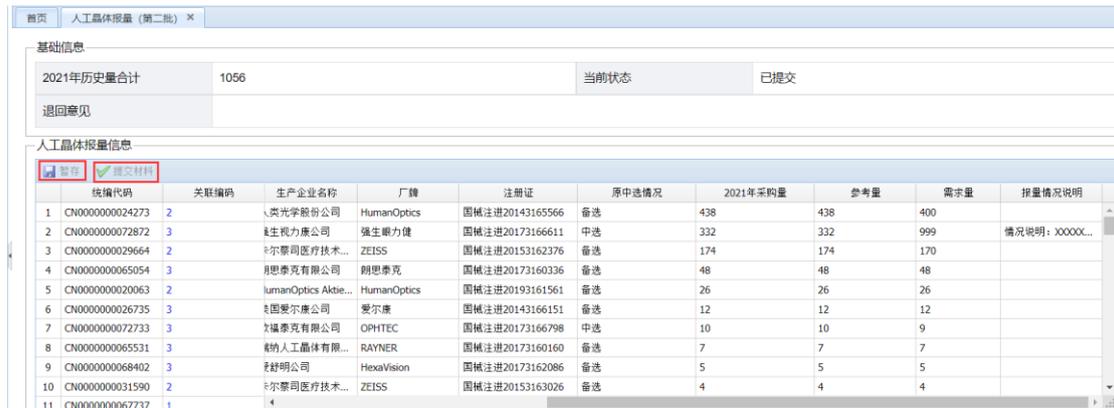


图 2-1-5 提交成功后所有按钮变灰